

premio 32 v evo

laser froid de bio-stimulation



VÉTÉRINAIRE

CHEVAUX

CHIENS, CHATS

NAC

Sedatelec®
YOUR WAY OF CARE,
OUR QUALITY DEVICES

Une aide instantanée en toutes circonstances



Douleurs aiguës

Sédation en quelques minutes par augmentation de la micro-circulation. Tous types de douleurs, qu'elles soient d'origine organique ou neurogénique.

- De nature inflammatoire : tendinites, entorses, hernies discales, otites...
- De nature tumoral : ostéosarcome, tumeurs cérébrales...
- De nature traumatique : AVP de l'animal domestique, fractures, morsures

Pathologie musculaire de type contracture et inflammatoire

Libération de la tension musculaire en quelques minutes par action directe sur les capteurs de tension des jonctions musculo-tendineuses.

- Tendinite du cheval
- Contracture suite à luxation de l'épaule
- Pathologie du rachis dorsal ou cervical

Chirurgie

Cicatrisation accélérée et indolore par modulation de l'information nerveuse, stimulation des mitochondries et production d'ATP.

- Toutes interventions post traumatiques qu'elles soient osseuses, viscérales ou cutanées
- Morsures simples ou profondes à bords non jointifs
- Brûlures
- Interventions de confort

Affections / douleurs chroniques

Amélioration sensible après quelques séances régulières.

- Gingivostomatite du chat
- Arthroses, otite chronique
- Dysplasie de la hanche ou du coude
- Sacculite anale du chien, granulome de léchage
- Neuropathies périphériques ou dégénératives


La bio-stimulation laser

- **DYNAMISE** la synthèse protéique
- **AUGMENTE** la diffusion des cytokines, des neuromédiateurs
- **FAVORISE** l'oxygénation cellulaire


L'effcience Sedatelec

1 - Longueur d'onde : 905 nm

Peu d'absorption, meilleure effcience au sein de chaque couche tissulaire

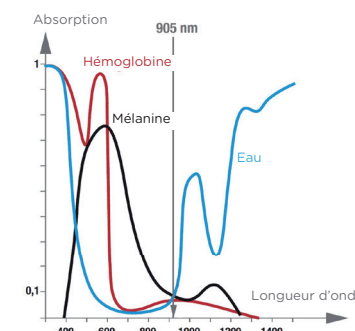


2 - Puissance Crête : 100 Watts

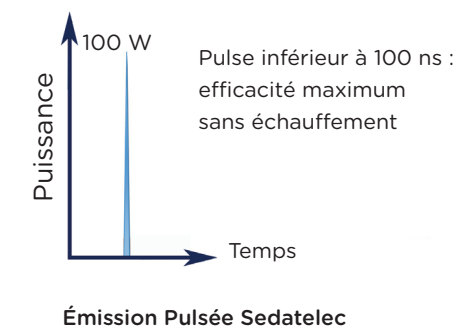

3 - Énergie délivrée : 2.5J/cm²/30sec

Émission super-pulsée modulée selon les fréquences de Nogier.

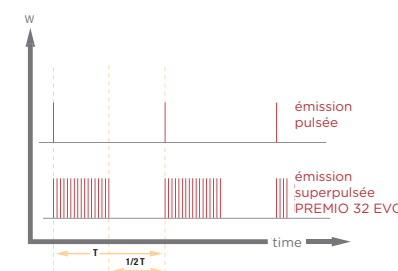


4 - Émission du Laser : les fréquences Nogier

Le Dr. Paul NOGIER a montré il y a plus de 40 ans que l'organisme était sensible à des stimuli fréquentés et réagissait différemment suivant les fréquences.

Depuis, de multiples travaux ont vérifié que l'efficacité du Laser fréquenté est bien supérieure au simple effet photonique de la source Laser elle-même.

premio 32 v ev

soft bio-stimulation laser

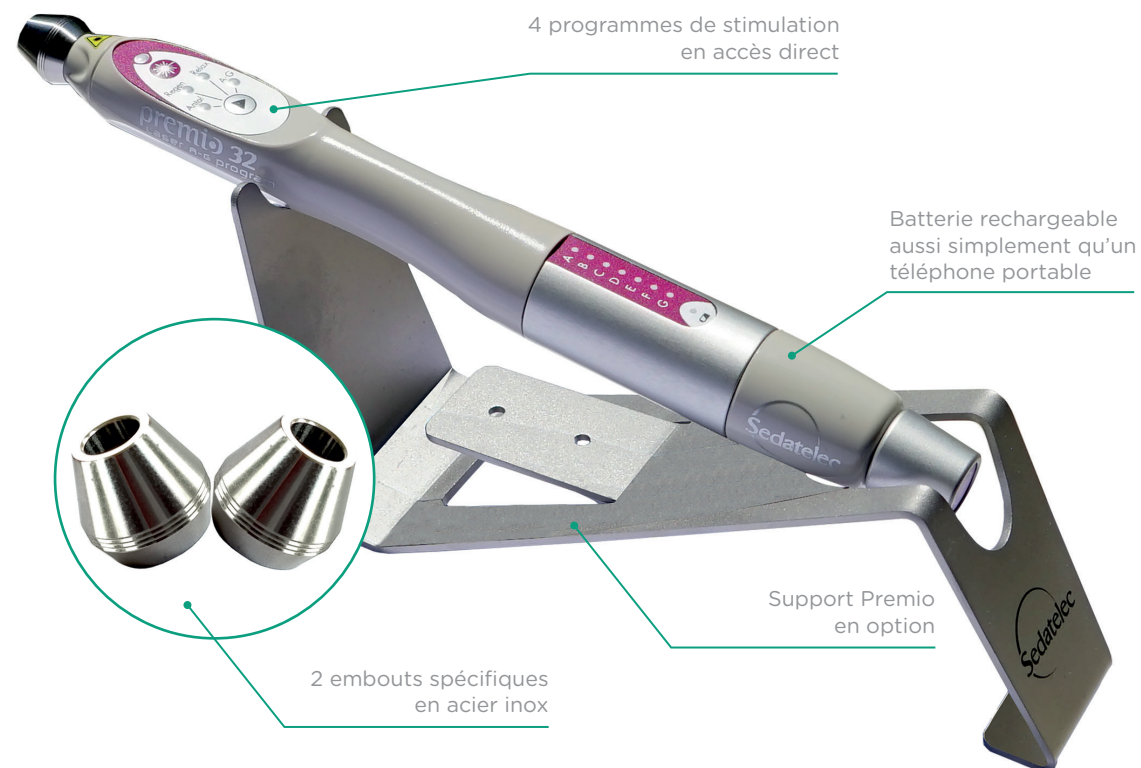

Révolutionnaire

Vous ne pourrez plus vous en passer, et vos patients non plus !



- SANS FIL** : pratique aisée, sans contrainte
- ÉCONOMIQUE** : pas de consommable
- ERGONOMIQUE** : accès direct aux 4 programmes par touches dédiées
- PRATIQUE** : affichage des fréquences utilisées, bip de repérage toutes les 30 secondes
- AUTONOMIE** : environ 6 heures en continu
- PRÉCIS** : éclairage de la zone de soins



Profitez d'une image positive.

Décuplez vos résultats en terme de satisfaction patients.

Le « + » Sedatelec : les fréquences Nogier

- **ANTAL** : action antalgique E et G
 - Réduit la transmission de la douleur au système nerveux central
 - Agit localement sur le processus douloureux et améliore le ressenti du patient
- **REGEN** : action reconstructive et anti-inflammatoire A, B et F
 - Restaure les fonctions cellulaires,
 - Agit sur la formation du cal osseux,
 - Accélère la reconstruction tissulaire, ainsi que les processus de cicatrisation et de régénération en surface comme en profondeur.
- **RELAX** : action myo-relaxante C, D et G
 - Relâche les tensions et les contractures des muscles en application locale.
- **A - G** : balayage des fréquences Nogier
 - Stimule les zones pathologiques quelle qu'en soit l'origine (douleurs ou troubles fonctionnels,...) par émission successive de toutes les fréquences Nogier

Sélection fréquentielle individuelle
action sur une fonction physiologique spécifiques

- A** = 2,28 Hz
Action anti-inflammatoire
- B** = 4,56 Hz
Stimulation des fonctions métaboliques
- C** = 9,12 Hz
Stimulation des fonctions de locomotion
- D** = 18,25 Hz
Stimulation des fonctions liées à la symétrie et à la latéralité
- E** = 36,5 Hz
Action antalgique
- F** = 73 Hz
Action cicatrisante
- G** = 146 Hz
Traitement des douleurs chroniques

les fonctions



40 ans d'expérience en soft laser

Créée en 1978, **Sedatelec** collabore avec le **Docteur Paul NOGIER** (1908-1996), et met au point **les premiers appareils électroniques et Laser froids** destinés aux vétérinaires..



Depuis la R&D jusqu'à la commercialisation, en passant par la fabrication, tout est « **Made in France** ».

Sedatelec garantit ses produits pendant 2 ans et son SAV est assuré dans ses locaux, à Lyon, jusqu'à 10 ans après l'arrêt de la commercialisation.

ISO 13485



Les effets du Soft Laser constatés par tous!

— ARTHROPATHIES CHRONIQUES

Dr. S. Mareuil, France

- Dans le cas d'arthropathies chroniques douloureuses telles que sésamoidite proximale, périostite (très douloureuse lors de suros ou sore shine chez le cheval). J'utilise le Laser Sedatelec en position «Antal » puis «Regen», 30 sec à 1 minute par zone et les résultats sont remarquables dès les 1ères séances.
- On note d'ailleurs que **les patients se détendent instantanément** en fermant les paupières et baissant la tête.

— CICATRISATION

Dr. A. Toulouse, France

- Après chaque traitement de plaies par morsures, ou lors de sutures chirurgicales, l'application du Laser Sedatelec en «Regen» permet une **accélération de la cicatrisation** telle que les suites sont toujours raccourcies et simplifiées.

— TENDINITES D'EFFORT

Dr. A. Lyon, France

- Lors des tendinites notamment celles du tendon fléchisseur superficiel chez le cheval, le traitement par le Laser Sedatelec permet d'une part de rapidement **diminuer la boiterie** et la sensibilité palpatoire de la zone traitée, et d'autre part une diminution du diamètre du membre lésé ce qui confirme **l'effet anti-œdémateux** lié à l'amélioration de la circulation sanguine.

— TENDINITES INDUITES

Dr B. Dardilly, France

- Lors d'un essai clinique randomisé testant le laser Sedatelec versus un laser placebo sur des tendinites induites chez le cheval, les examens cliniques (mesure du périmètre, température locale, boiterie,...), échographiques et histologiques ont tous confirmé **l'accélération du processus de régénération** des tendons expérimentalement lésés. La réparation est de qualité, et beaucoup plus rapide.

Plus d'études dans la base de données PUBMED.

Révolutionnaire portable et économique

Redonnez la santé
à vos patients avec la dernière
technologie en Laser
de Bio-Stimulation

Livré avec sa mallette comprenant :

- Le PREMIO 32 EVO
- 2 embouts spécifiques en inox renforcé
- 1 testeur de contrôle d'émission
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 clé de sécurité et un chargeur
- 1 embout de réduction de puissance



*Avant toute utilisation, lire attentivement
le mode d'emploi*



*Appareil à laser de classe 3B selon IEC 60825-1
Rayonnement laser invisible*

Exposition au faisceau dangereuse pour les yeux.

Caution : Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.



cachet distributeur

Fabriqué en France



Chemin des Mûriers • 69540 Irigny (Lyon) • France
Tel : +33 (0) 472 663 322 / Fax : +33 (0) 478 508 903
contact@sedatelec.com • www.sedatelec.com